Iridología

Iriscopio de 5.0 Megapíxeles Modelo IR-9915U



Iridología
Iriscopio de 5.0 Megapíxeles Modelo IR-9915U

Instalación:

1. Ingrese el CD de instalación en su computador y permita que cargue el menú principal.
No conecte el Iriscopio!


Si no cuenta con un CD de instalación, por favor contacte a su distribuidor de IrisCopio.com-USA Corp. para que le suministren un enlace de Descarga.




2. Presione en "*Instalar Iriscopio*".




3. Conecte el Iriscopio al puerto USB cuando se le indique, y Presione "Yes" (Si). Seguidamente Presione "Next".

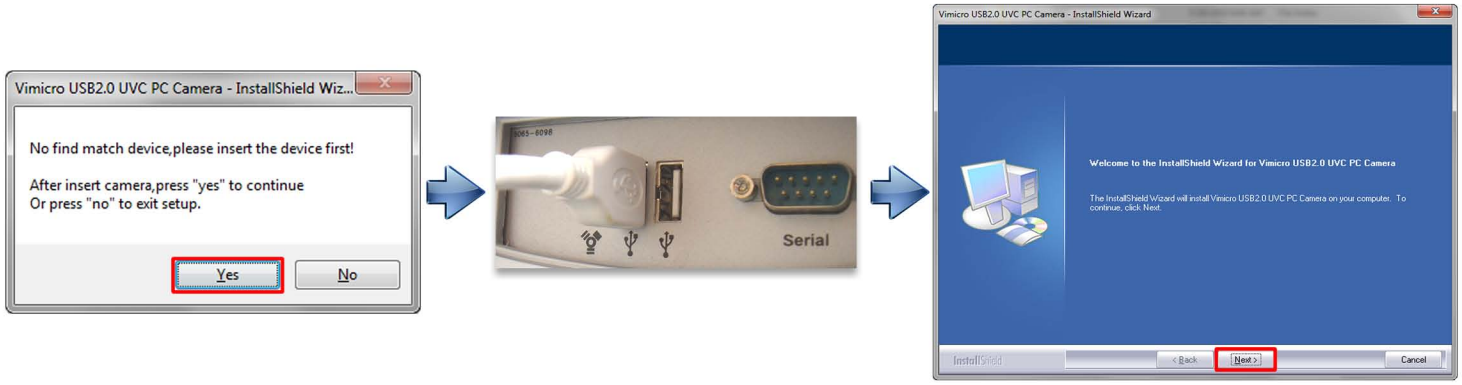

4. Seleccione la primera opción. "Yes, I want to restart my computer now." (Si, deseo reiniciar mi computador ahora).

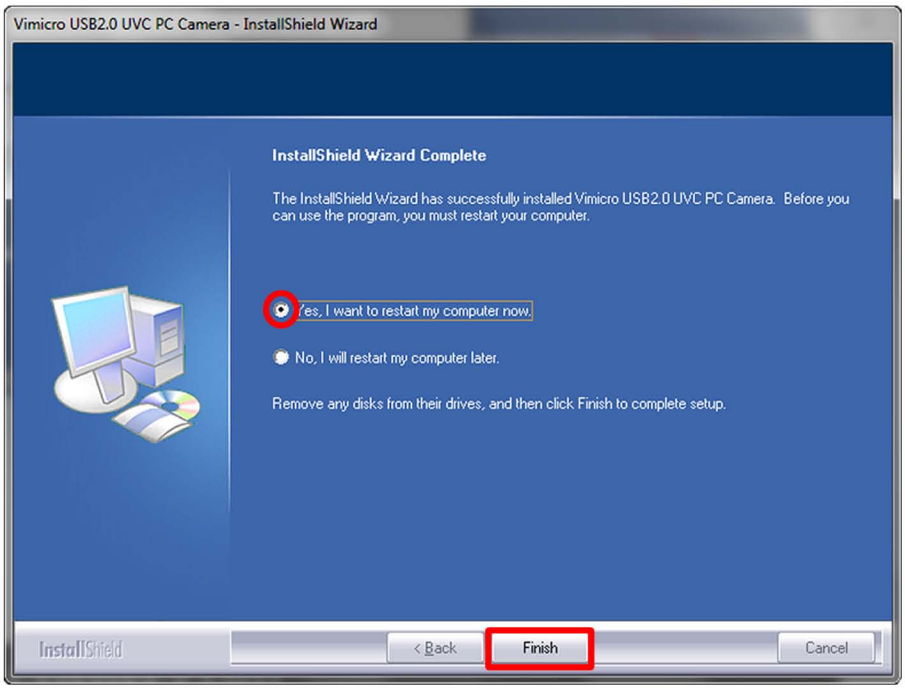


5. Presione "Finish" (Terminar). Desconecte el iriscopio.

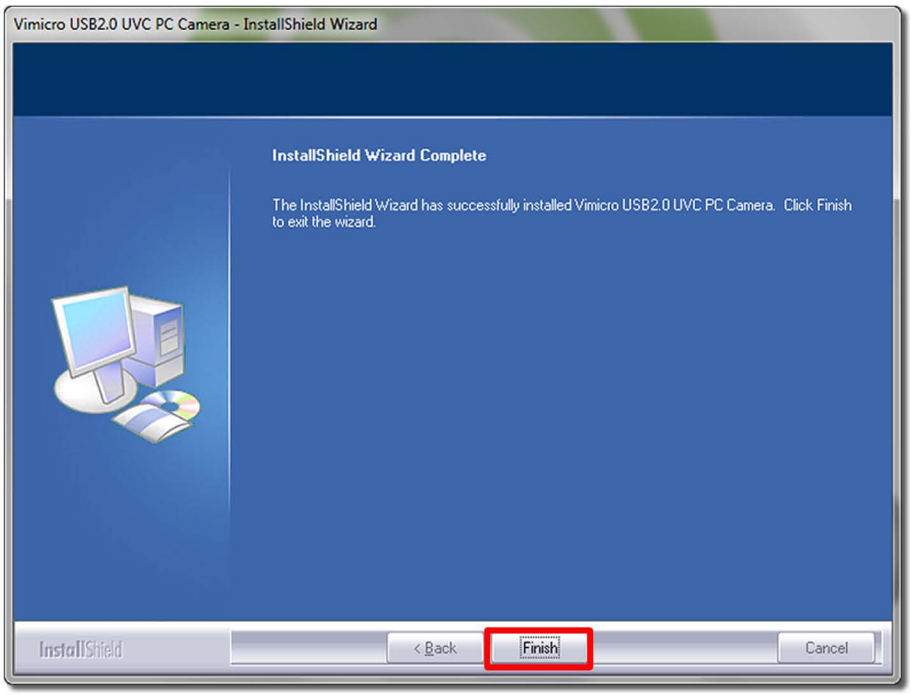


6. Conecte el iriscopio y espere a que el computador detecte el iriscopio.





Configuración:


1. Ensamble el lente cuidadosamente al Iriscopio, (*acoplando los polos con sus respectivos agujeros y girando el lente con sentido de las manecillas del reloj suavemente*).

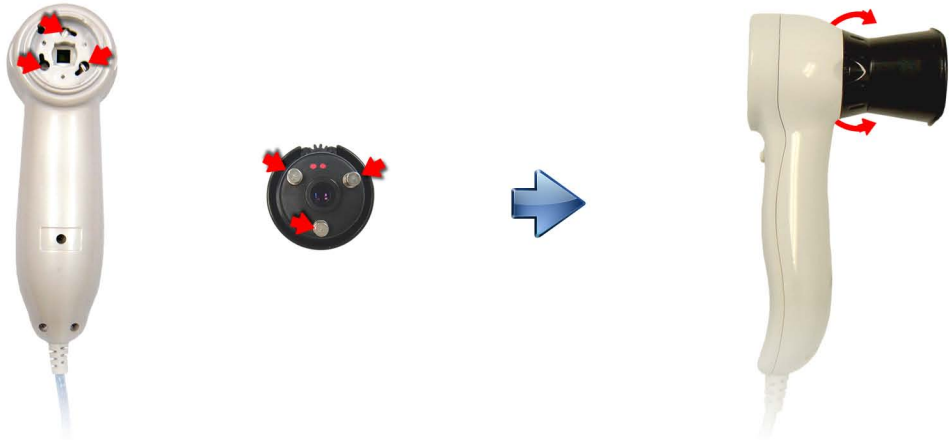


2. Presione el ícono "amcap" que aparece en la pantalla principal de su computador.



3. Presione "Devices". Seleccione "Vimicro USB2.0 UVC PC Camera"

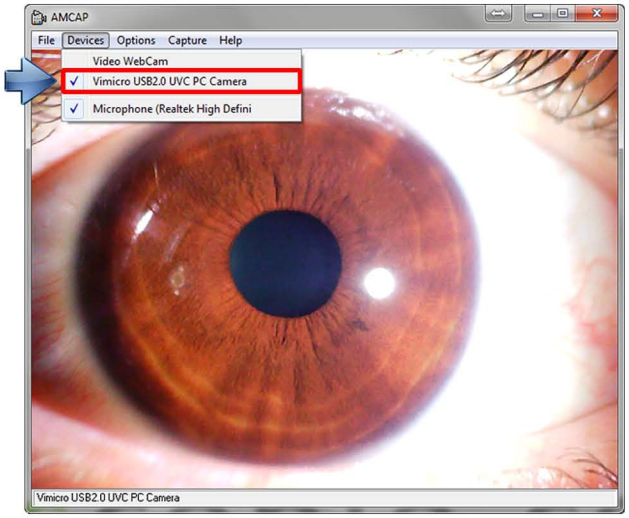


Si la imagen no aparece en pantalla, presione: "Options" y "Preview"

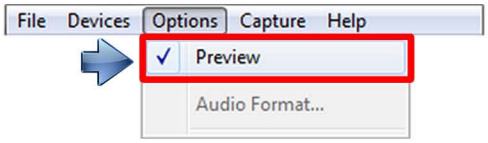


4. Encienda las luces presionando los botones que se encuentran en el Iriscopio. Luz Izquierda (L) y Luz Derecha (R).




5. Presione "Options". Seleccione "Video Capture Filter..."

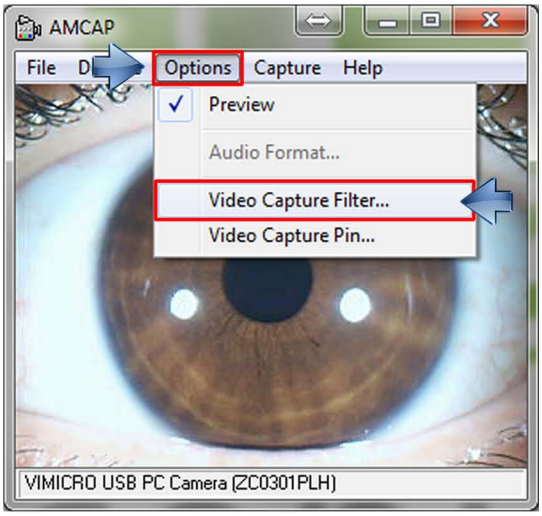


6. Configure el Brillo, Contraste, Saturación, etc. Si desea puede desactivar el "Blanco Automático" desactivando la casilla. Cuando este satisfecho, presione "Aplicar" y "OK".

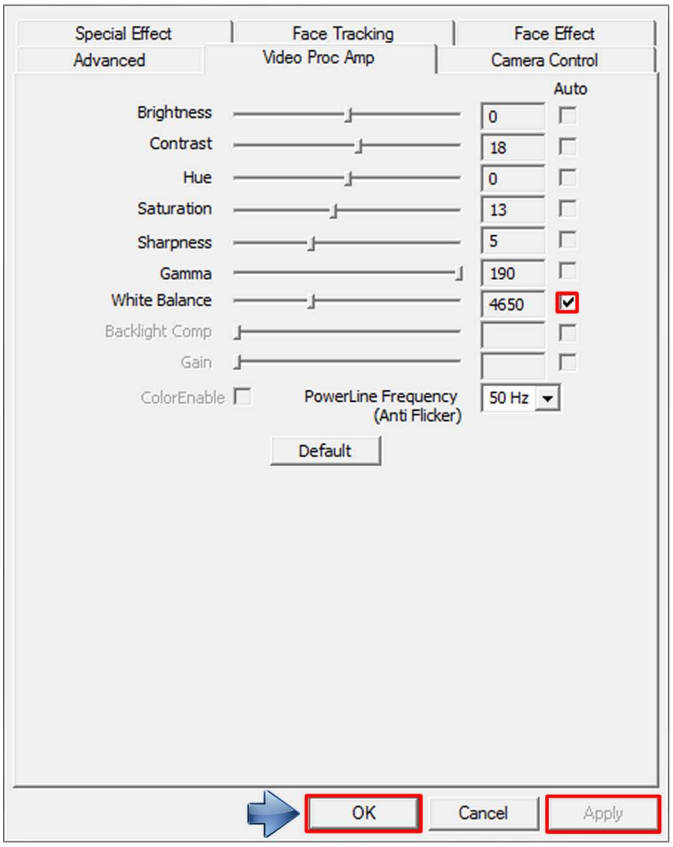


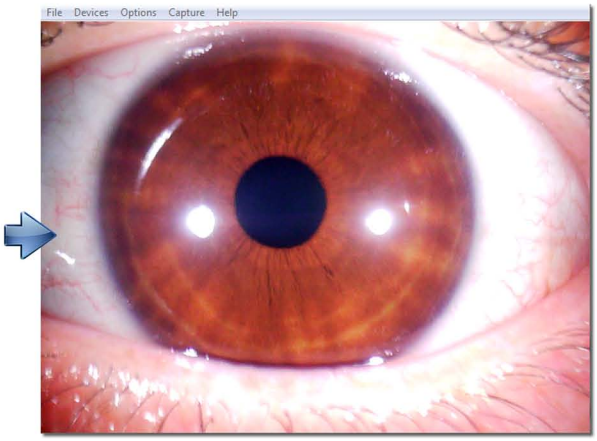

7. Presione "Options". Seleccione "Video Capture Pin..."

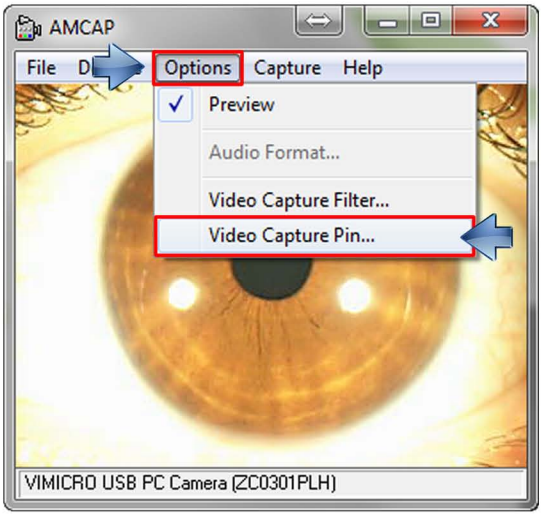

8. En "Output Size" (Tamaño de Salida), seleccione 640 x 480 y presione "OK".

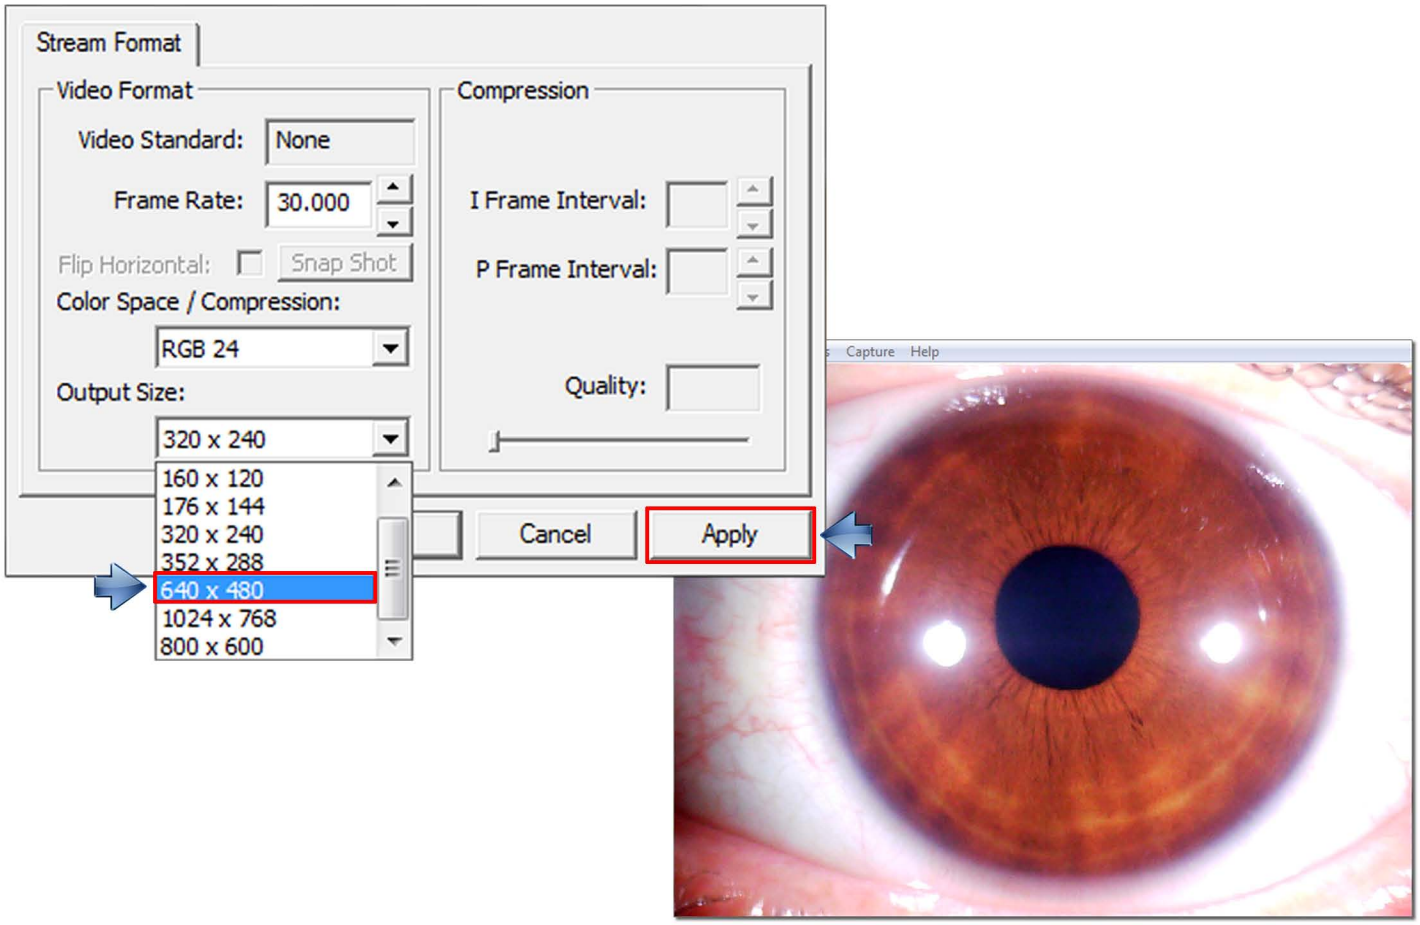

9. Gire la rueda de enfoque hasta mejorar la nitidez de la imagen. Se recomienda probar encendiendo y apagando las luces simultáneamente y/o alternativamente. *Recuerde abrir bien los párpados!* Oprima el botón "CAPTURE" para capturar la imagen deseada. (*Si el botón no captura..no se preocupe, al momento de utilizar el programa Dual Analysis System™ se activará automáticamente y podrá utilizarlo*). Seguidamente presione "Cerrar" (X).



